


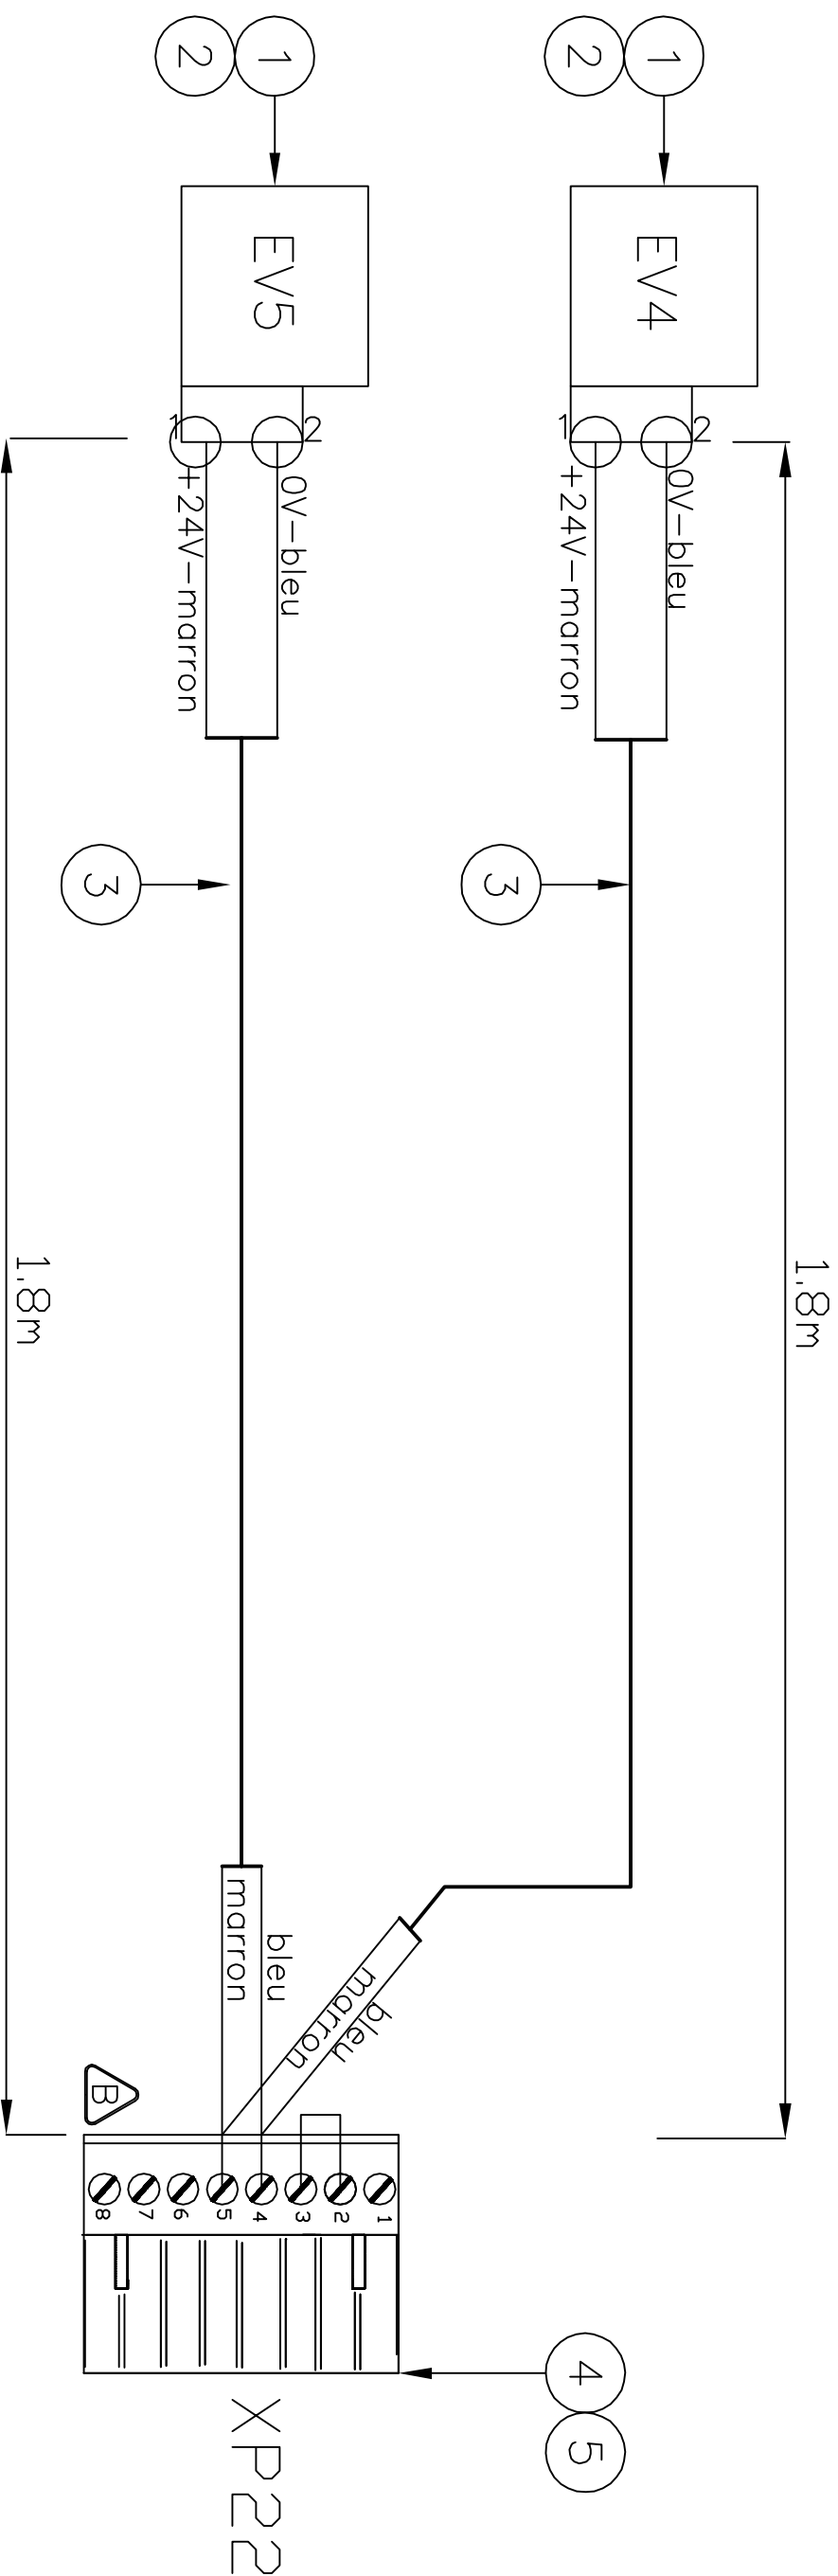

REP	QTE	DESIGNATION	REF
1	2	Connecteur IP65 pour électrovannes	228289
2	4	Embout de câblage isolé 1mm²	100659
3	3,6m	Câble 3G1mm² HD5VVF	219783
4	1	Connecteur PHOENIX 8pts pas. 3,81mm	228499
5	2	Embout de câblage double isolé 1,5 mm²	229580

TECHNOMED
Medical Systems

Parc d'activité la Poudrette Lormont
4, Rue du Dauphin,
66120 VALUX EN VELIN - FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith (((((i-sys (Module)

Designation : CABLE 24 / ALIMENTATION ELECTROVANNES

Designation : MODE MAINTENANCE

	Echelle : Scale :	Date : Date :	Folio : 1/1	Protection : Protection :
---	----------------------	------------------	----------------	------------------------------

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.

The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.

B	06/02/2008	Mod connection XP22		NGU	CCA
	Date : Date :	Modification : Modification :	ERCO N°:	Modifie par : Modified by :	Verifie par : Checked by : 

Dessiné par :	NGU	Vérifié par :	RCH	Format :	A3	N° du plan :	TMS 229633	B
Drawn by :		Checked by :						

Ce document est la propriété de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers.

The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.