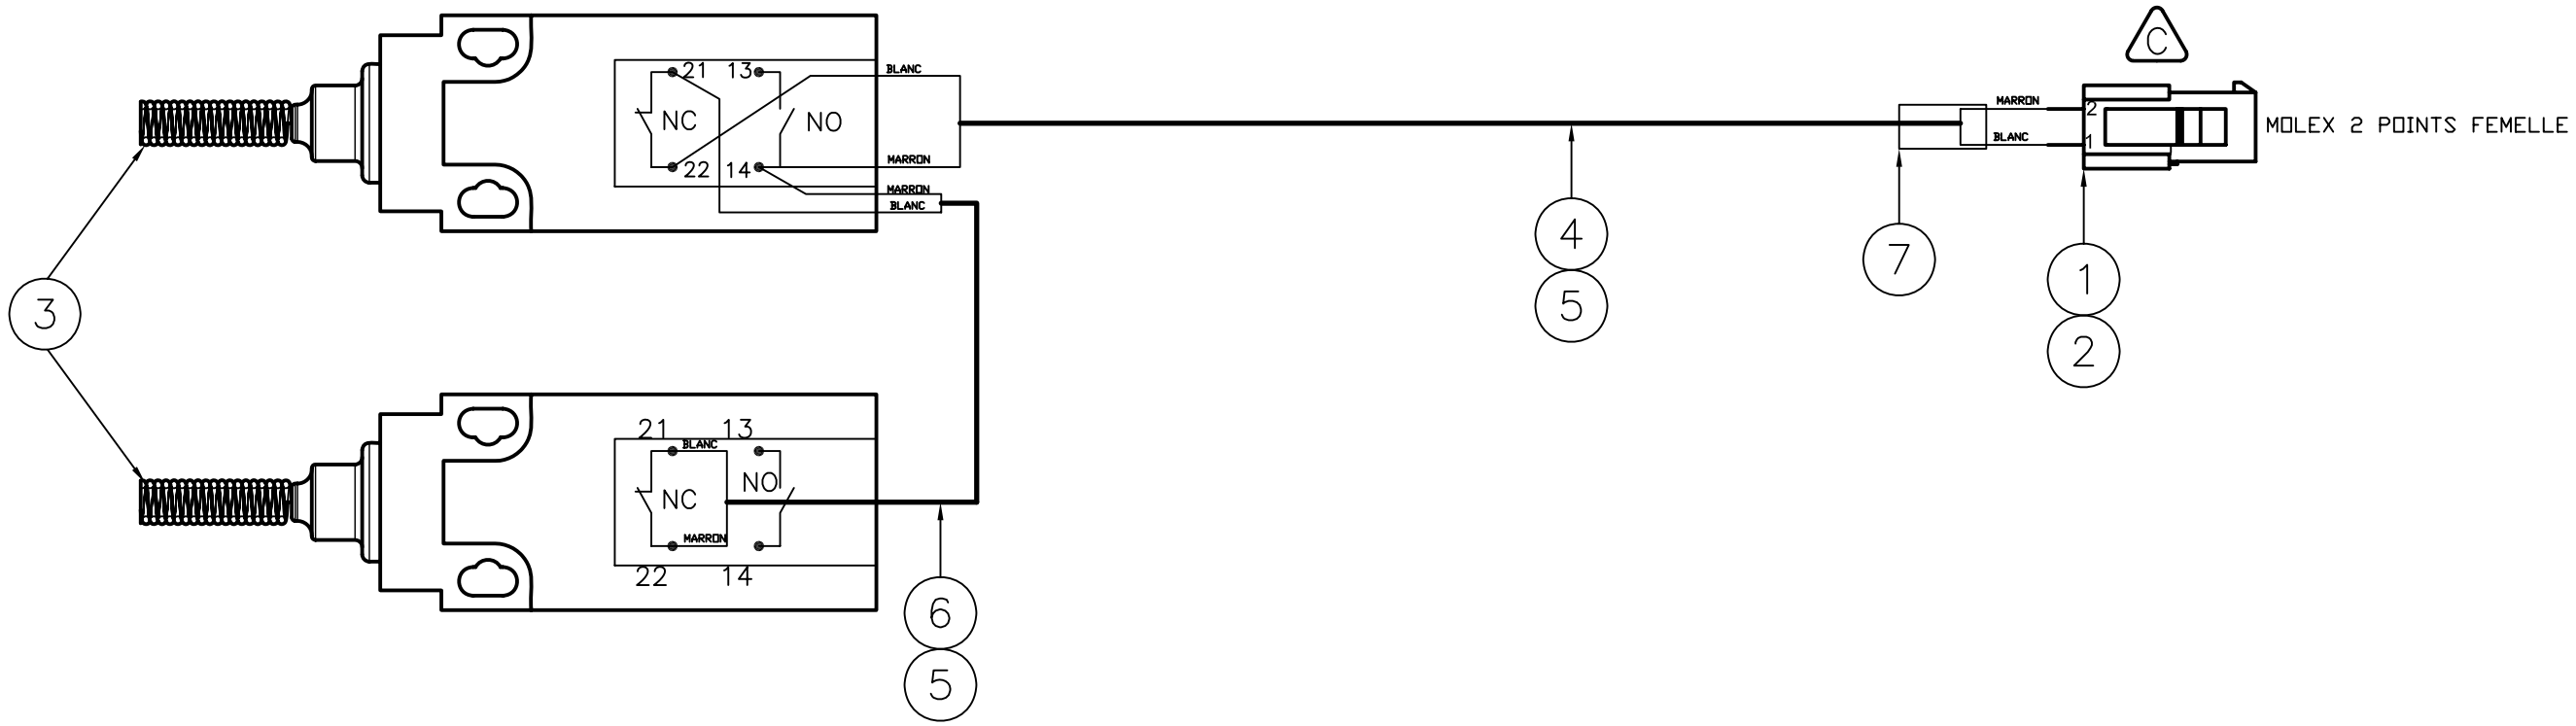

	REP	QTE	DESIGNATION	REF
C	1	1	Connecteur Molex 2 pts femelle	230152
	2	2	Contact male MOLEX 18-24 AWG	226933
	3	2	Interrupteur à tige souple	229940
	4	0.4m	Cable 4x0.25mm² non blindé	229647
C	5	6	Embout de cablage isolé blanc 0.25 mm²	229581
	6	0.55m	Cable 4x0.25mm² non blindé	229647
	7	1	Gaine thermorétractable D6.4mm lg:20mm	C□0460

Ind.	Date : Date :	Modification : Modification :	ERCO N°:	Modifie par : Modified by :	Verifie par : Checked by :
C	12/12/2007	Mise à jour rep.6 (qté) + rep.1(ref)		NGU	CCA
B	08/11/2007	Modif. repérage connecteur		NGU	CCA
A1	09/10/2007	Changement nomo. rep3		NGU	RCH

TECHNOMED Medical Systems
Parc d'activité la Poudrette Lamartine
4 Rue du Dauphiné.
69120 VAULX EN VELIN – FRANCE
Téléphone : (33) 4.72.15.31.50
Télécopie : (33) 4.72.15.31.51

Sonolith ((((i-sys (Module)

Designation : ANTI COLLISION SOURCE EQUIPE

Designation :

Matiere : *Material :*
Traitement : *Treatment :*
Tolerance generale : *General tolerance :*
Usinage general : *Machining :*
Protection : *Protection :*

Echelle : *Scale :* | Date : *Date :* 09/08/07 | Folio : 1/1

Dessine par : *Drawn by :* NGU | Verifie par : *Checked by :* RCH | ERCO : | Format : A3 | N° du plan : *Plan N° :* TMS 229649 | C

Ce document est la propriete de TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS il ne peut etre reproduit ni communique a des tiers.
The copyright of this drawing remains exclusive to TECHNOMED MEDICAL SYSTEMS.