



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 00209023

Casa Matriz:
Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua.
Fono: 2751 8400
Comuna: Quilicura - Santiago.
Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:
Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano - Concepción
Fono:(041) - 325 5253
Comuna: Talcahuano - Talcahuano

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE


SEÑOR (ES) : HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. : 61.608.406 -2
DIRECCION : AVDA. RANCAGUA 756
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : HOSPITAL
COMENTARIOS : OC: MANTENCION

FECHA EMISION : 20 de diciembre de 2023
TELEFONO :
IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA

Sírvase recibir conforme lo siguiente: a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
OAM001523	BLAST SHIELD ()	UN	1			1
<p>(OV: 260817) EQUIPO EN GARANTIA NUMERO DE SERIE CYH 1846-0523 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9. Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-</p>						

Son: UNO PESOS

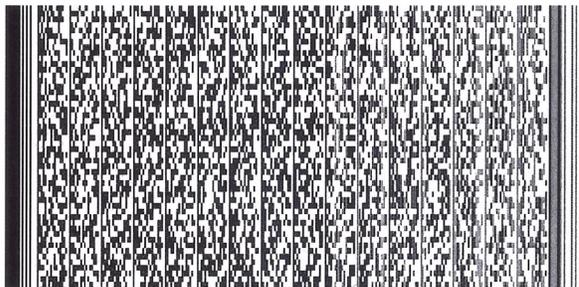

Neto \$ 1
19% I.V.A \$ 0
Total \$ 1

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Daniela B. Muñoz
Enfermera

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)''



CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA S.A.

DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE INSUMOS, FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
COMERCIALIZACION DE INSUMOS FARMACOS Y EQUIPOS MEDICOS
MANTENCION Y REPARACION DE EQUIPOS MEDICOS

R.U.T.: 96.515.660-7
GUIA DE DESPACHO
ELECTRONICA
N° 00209023

Casa Matriz:
Av. Galvarino 7640, Parque Aconcagua.
Fono: 2751 8400
Comuna: Quilicura - Santiago.
Mail: cencomex@cencomex.cl

Sucursal:
Calle Autopista 5980
Autopista Talcahuano - Concepción
Fono:(041) - 325 5253
Comuna: Talcahuano - Talcahuano

S.I.I. - SANTIAGO ORIENTE


SEÑOR (ES) : HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. : 61.608.406 -2
DIRECCION : AVDA. RANCAGUA 756
COMUNA : PROVIDENCIA
CIUDAD : SANTIAGO
GIRO : HOSPITAL
COMENTARIOS : OC: MANTENCION

FECHA EMISION : 20 de diciembre de 2023
TELEFONO :
IND. TRASLADO DE BIENES: OTROS NO VENTA

Sírvase recibir conforme lo siguiente: a: Central de Compras del Extrasistema S.A.

CODIGO	DESCRIPCION	PPA VOL COM	CANTIDAD	LOTE SERIE	FECHA EXPIRACION	PRECIO TOTAL
OAM001523	BLAST SHIELD ()	UN	1			1
<p>(OV: 260817) EQUIPO EN GARANTIA NUMERO DE SERIE CYH 1846-0523 (Choferes: ERWIN ROJAS 15.528.044-1, VICTOR MARTINEZ 14.167.256-8, JUAN ROSALES 12.256.692-7, SIMON CONTRERAS 17.463.397-5, JONATHAN CARCAMO 17.732.922-3, ENIO RIOBO 16.389.975-2, AMADO MATAMALA VERGARA 17.912.962-0, DIEGO RUBIO 17.732.182-9. Patentes: LPCB-57, KGXF-87, LXJX-72, LXJX-71, HHYG-69, FWLX-32, HWHY-</p>						

Son: UNO PESOS

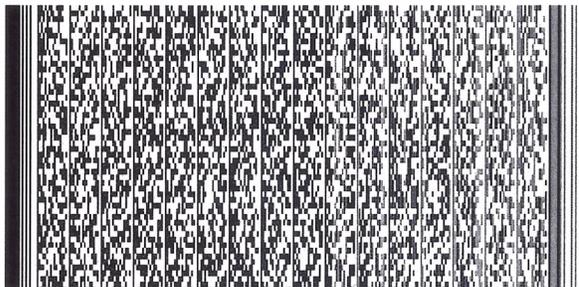

Neto \$ 1
19% I.V.A \$ 0
Total \$ 1

Nombre: _____ R.U.T.: _____
 Recinto: _____ Fecha: _____ Firma: _____

Daniela B. Muñoz
Enfermera

El acuse de recibo que se declara en este acto, de acuerdo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 4° y la letra c) de la ley 19.983, acredita que la entrega de mercadería o servicio(s) prestado(s) ha(n) sido recibido(s)"

FECHA: 21 / 12 / 23

Cliente: Hospital del Salvador

Dirección: _____

Ciudad: Santiago Fono contacto: _____

Equipo/Sistema: LASER Marca: Quanta System

Modelo: Cyber HO 100 Serie: CYH 1346-0523

Servicio:

Mant Preventiva Mant Correctiva Otro (especificar)

Tipo de falla:

Pieza quebrada Accesorio Ajuste/ Calibración Cambio repuesto

Mecánica Eléctrica Software Alimentación / Batería

Otra (especificar):

Descripción Trabajo:

BlartShield quemado, procede a Reemplazo de BlartShield


Revisión de Banco óptico .OK

Drenado y posterior rellenado de agua bidestilada


Pruebas de disparo y revisión de niveles de energía ✱

Equipo 100% operativo.

Hora Inicio: Hora Termino:

Nombre	 Daniela B. Alvarez Enfermera
Cargo	
Firma	

CLIENTE

Nombre	<u>Natalia Espinoza</u>
Cargo	<u>Ingeniero de campo.</u>
Firma	

CENCOMEX